orthopaedic & spine development

Safe and Innovative Solutions

SQUALE™

SQUALE™

Cage Cervicale

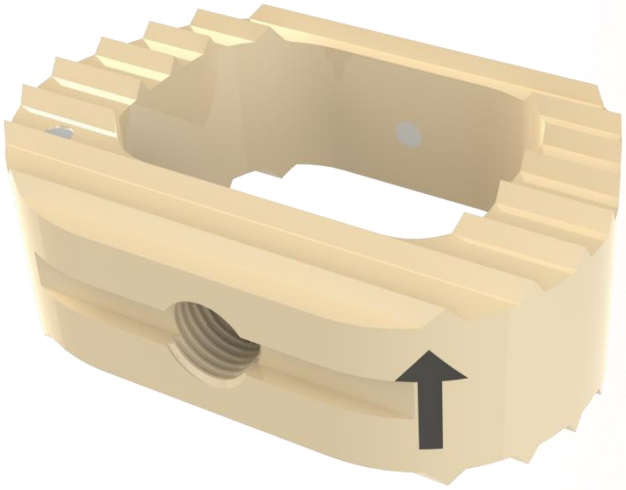

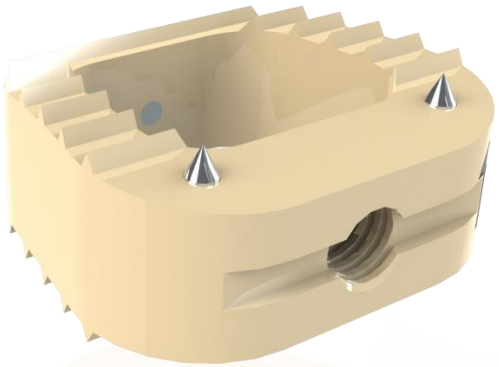

Mini-SQUALE™

Cage cervicale con denti

SQUALE™

Eccellente stabilità e posizionamento

Confezione sterile

Disegno adattato all'anatomia vertebrale

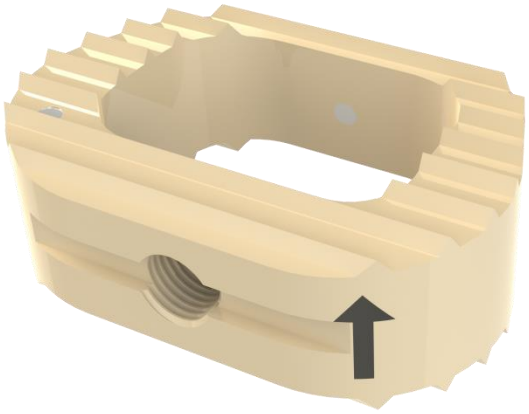

Solchi antimigrazione e anti micromovimenti

Ampia superfice di contatto

Sistema antirotazione per la fase d'impianto

Marker in tantalio per facilitare il controllo della posizione

Impianto in OXPEKK®

Realizzato in Francia e Svizzera

- Impianto radiotrasparente per un miglior controllo della fusione
- Ampio foro di contenimento dell'osso

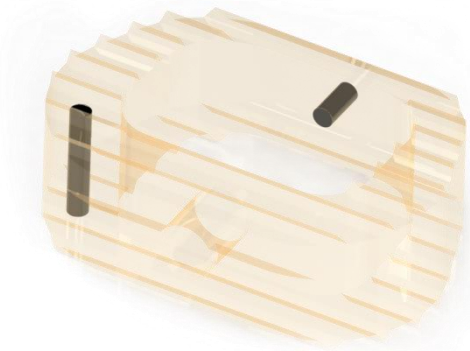

Mini-SQUALE™

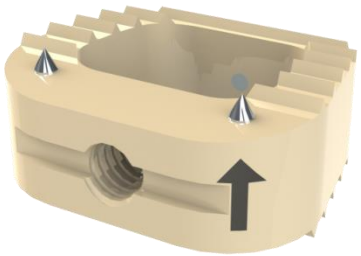

- Cage piccola per un posizionamento più facile : Solo 14 mm di larghezza
- 4 denti in titanio per un migliore ancoraggio primario sui corpi vertebrali

Impianto in OXPEKK ®

SQUALE™

Sostituto d'osso sintentico

Caratteristiche Tecniche :

- 100 % sintetico
- Osteoconduttivo
- 60 % Hydroxyapatite
- 40% Tricalcium Phosphate β-TCP
- Porosità del materiale : 300 – 600 µm

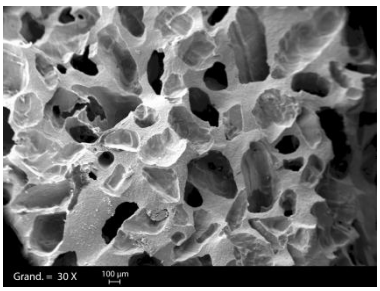

Macropores
(300 – 600 µm)

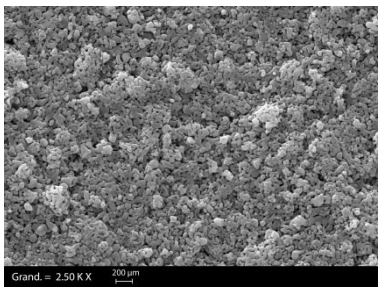

Micropores
(< 10 µm)

Vantaggioso rispetto al trapianto Allograft e Autologo :

- Risultati equivalenti ad un impiato d'osso autologo
- Minori problemi di osteo integrazione
- Assenza di dolore e di infezioni al livello d'impianto
- Assenza di reazioni allergiche

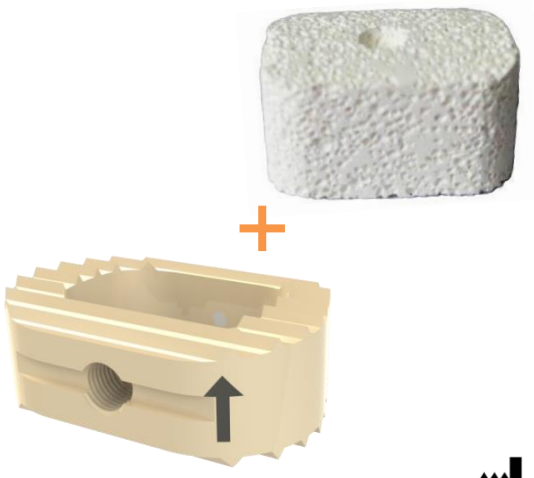

Pratico :

- Preformato secondo il disegno della cage
- Confezione sterile
- Radio-opaco

Fabricant : **Biomatlante**
5 rue Edouard Belin – 44360 Vigneux de Bretagne – France
www.biomatlante.com

Strumenti ancillari

Unico strumentario per tutti i tipi di SQUALE

Strumenti semplici e intuitivi: solo due impattatori
e impianti di prova

Codici	Descrizione
SQA-IM	Supporto per impianto di prova
A-IMS-0001	Impattatore/Supporto per impianto
SQA-FA-141304	Impianto di prova per 14 x 13 x 04 mm
SQA-FA-141305	Impianto di prova per 14 x 13 x 05 mm
SQA-FA-141306	Impianto di prova per 14 x 13 x 06 mm
SQA-FA-141307	Impianto di prova per 14 x 13 x 07 mm
SQA-FA-1704	Impianto di prova per 17 x 13 x 04 mm
SQA-FA-1705	Impianto di prova per 17 x 13 x 05 mm
SQA-FA-1706	Impianto di prova per 17 x 13 x 06 mm
SQA-FA-1707	Impianto di prova per 17 x 13 x 07 mm
SQA-FA-1708	Impianto di prova per 17 x 13 x 08 mm
SQA-FA-2004	Impianto di prova per 20 x 15 x 04 mm
SQA-FA-2005	Impianto di prova per 20 x 15 x 05 mm
SQA-FA-2006	Impianto di prova per 20 x 15 x 06 mm
SQA-FA-2007	Impianto di prova per 20 x 15 x 07 mm

Codici

Gamma ampia e completa

Codice	Descrizione – Larghezza x Lunghezza x Altezza
SQP-CP-141304S	Cage cervicale 14 x 13 x 04 mm
SQP-CP-141305S	Cage cervicale 14 x 13 x 05 mm
SQP-CP-141306S	Cage cervicale 14 x 13 x 06 mm
SQP-CP-141307S	Cage cervicale 14 x 13 x 07 mm
SQA-CP-1704S	Cage cervicale 17 x 13 x 04 mm
SQA-CP-1705S	Cage cervicale 17 x 13 x 05 mm
SQA-CP-1706S	Cage cervicale 17 x 13 x 06 mm
SQA-CP-1707S	Cage cervicale 17 x 13 x 07 mm
SQA-CP-1708S	Cage cervicale 17 x 13 x 08 mm
SQA-CP-2004S	Cage cervicale 20 x 15 x 04 mm
SQA-CP-2005S	Cage cervicale 20 x 15 x 05 mm
SQA-CP-2006S	Cage cervicale 20 x 15 x 06 mm
SQA-CP-2007S	Cage cervicale 20 x 15 x 07 mm

CE 0459

Codice	Descrizione
SQP-BS-141304	Innesto osseo sintetico per Cage SQUALE SQP-CP-141304S
SQP-BS-141305	Innesto osseo sintetico per Cage SQUALE SQP-CP-141305S
SQP-BS-141306	Innesto osseo sintetico per Cage SQUALE SQP-CP-141306S
SQP-BS-141307	Innesto osseo sintetico per Cage SQUALE SQP-CP-141307S
SQA-BS-1704	Innesto osseo sintetico per Cage SQUALE SQA-CP-1704S
SQA-BS-1705	Innesto osseo sintetico per Cage SQUALE SQA-CP-1705S
SQA-BS-1706	Innesto osseo sintetico per Cage SQUALE SQA-CP-1706S
SQA-BS-1707	Innesto osseo sintetico per Cage SQUALE SQA-CP-1707S
SQA-BS-1708	Innesto osseo sintetico per Cage SQUALE SQA-CP-1708S
SQA-BS-2004	Innesto osseo sintetico per Cage SQUALE SQA-CP-2004S
SQA-BS-2005	Innesto osseo sintetico per Cage SQUALE SQA-CP-2005S
SQA-BS-2006	Innesto osseo sintetico per Cage SQUALE SQA-CP-2006S
SQA-BS-2007	Innesto osseo sintetico per Cage SQUALE SQA-CP-2007S

CE 0123

orthopaedic & spine development

www.osdevelopment.fr

Distribuito da :

Orthopaedic & Spine Development (OSD)
Technopôle Agroparc – BP 11211 - 84911 Avignon Cedex 9 – France
www.osdevelopment.fr / info@osdevelopment.fr
Tel : +33 (0)4 32 74 01 10 – Fax : +33 (0)4 90 80 02 39

SQA-BRO-IT201502